

Figura 3.18 Esquema básico de la Mini-célula isotrópica rígida con control de succión.



Figura 3.19 1) Cuerpo superior (cámara de confinamiento 29 mm de espesor, 2) Muestra montada en el pedestal, 3) cuerpo inferior de la mini-célula con control de succión.

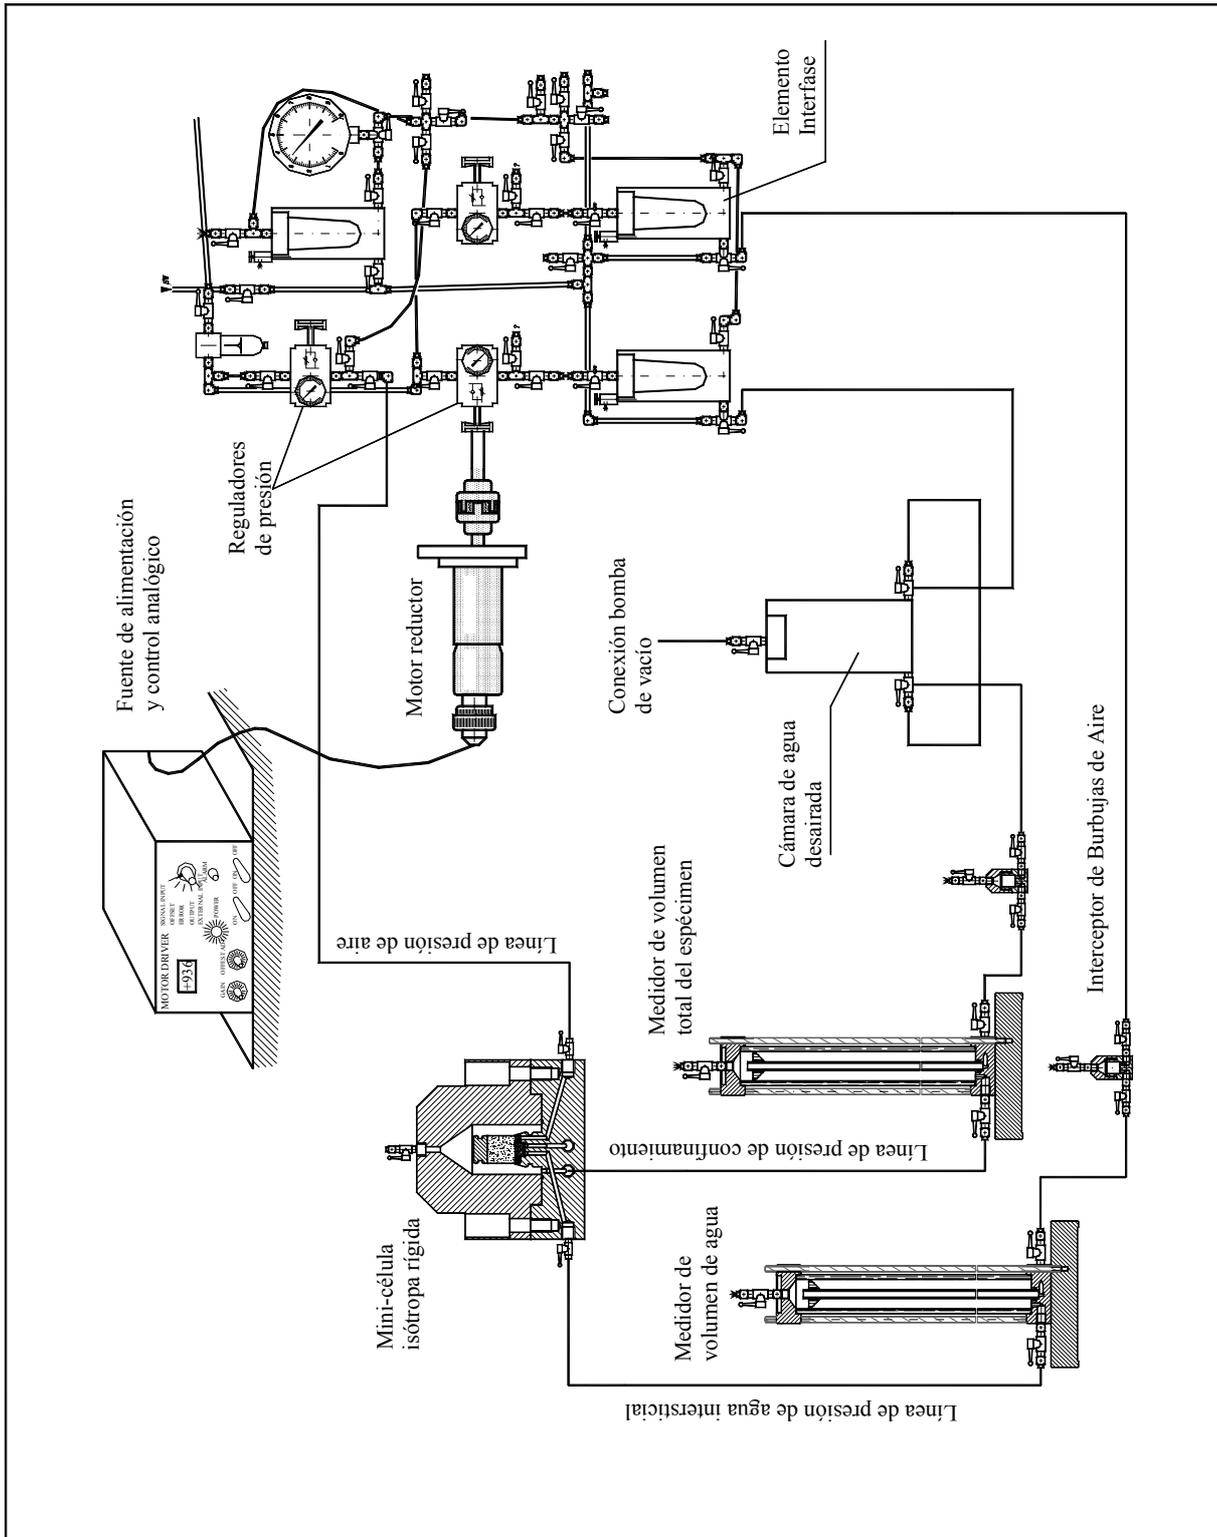


Figura 3.20 Conexiones entre la mini-célula isotropa básica y los equipos complementarios.